



The OxyChin™ is a minimal contact, open oxygen delivery device for use with USP medical grade oxygen.

**(FR)** L'appareil d'oxygène OxyChin<sup>MC</sup> est un dispositif à contact minimal servant à la livraison de l'oxygène de classe médicale USP.

**(ES)** El OxyChin<sup>MC</sup> es un dispositivo de contacto mínimo de entrega abierta de oxígeno para uso con oxígeno de grado medicinal USP.

**REF** OC-2025-8



Warning: Hypercapnia will not be reliably detected by sampling through this device, the displayed CO2 values will vary with the sampling port position, oxygen flow rate and respiratory pattern.

Avertissement: L'hypercapnie ne sera pas toujours détectée par l'échantillonnage avec ce dispositif; les valeurs CO2 affichées varieront en fonction de la position du port d'échantillonnage, du débit d'oxygène et du caractère de la respiration.

Advertencia: La hipercapnia no puede ser detectada en forma confiable por muestras tomadas con este dispositivo. Los valores de CO2 variarán con la posición del puerto de muestreo, la tasa de flujo de oxígeno y el patrón respiratorio.

Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death. Do not smoke while using this device.  
Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.

Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Precaución: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte. No fume mientras esté usando este dispositivo.

Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.



50 Alliance Blvd.  
Barrie, Ontario  
Canada L4M 5K3  
705-726-9383  
705-728-9537 FAX  
[thebetteroxygenmask.com](http://thebetteroxygenmask.com)

Made in Canada

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU00340



The OxyChin™ is a minimal contact, open oxygen delivery device for use with USP medical grade oxygen.

**(FR)** L'appareil d'oxygène OxyChin<sup>MC</sup> est un dispositif à contact minimal servant à la livraison de l'oxygène de classe médicale USP.

**(ES)** El OxyChin<sup>MC</sup> es un dispositivo de contacto mínimo de entrega abierta de oxígeno para uso con oxígeno de grado medicinal USP.

**REF** OC-2025-8



Warning: Hypercapnia will not be reliably detected by sampling through this device, the displayed CO2 values will vary with the sampling port position, oxygen flow rate and respiratory pattern.

Avertissement: L'hypercapnie ne sera pas toujours détectée par l'échantillonnage avec ce dispositif; les valeurs CO2 affichées varieront en fonction de la position du port d'échantillonnage, du débit d'oxygène et du caractère de la respiration.

Advertencia: La hipercapnia no puede ser detectada en forma confiable por muestras tomadas con este dispositivo. Los valores de CO2 variarán con la posición del puerto de muestreo, la tasa de flujo de oxígeno y el patrón respiratorio.

Caution: Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death. Do not smoke while using this device.  
Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

Mise en garde: L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif.

Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

Precaución: El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte. No fume mientras esté usando este dispositivo.

Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.



50 Alliance Blvd.  
Barrie, Ontario  
Canada L4M 5K3  
705-726-9383  
705-728-9537 FAX  
[thebetteroxygenmask.com](http://thebetteroxygenmask.com)

Made in Canada

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

IFU00340






thebetteroxygenmask.com

Oxygen Flow Settings	Approximate O2 Concentrations
1 LPM	24%-27%
2 LPM	28%-31%
4 LPM	32%-35%
6 LPM	36%-39%
8 LPM	40%-43%
10 LPM	42%-47%
12-15 LPM	48%-50%

Oxygen concentration, FiO2, levels are approximated by the table. End-tidal CO2 sampling waveforms are well defined at gas flows of up to 8 LPM, but waveforms will be damped or diminished at a flow rate greater than 8 LPM.

La concentration d'oxygène et les niveaux FiO2 approximatifs paraissent dans la table. Les formes d'onde d'échantillonnage CO2 en fin d'expiration sont bien définies à des vitesses d'écoulement du gaz de jusqu'à 8 l/mm, mais les formes d'onde seront diminuées à des vitesses de plus de 8 l/mm.

Los niveles de concentración de oxígeno, FiO2, son aproximados en la tabla. Las formas de onda de la muestra de CO2 remanente están bien definidas para flujos de gas de hasta 8 LPM, pero las formas de onda serán apagadas o disminuidas a una tasa de flujo mayor que 8 LPM.

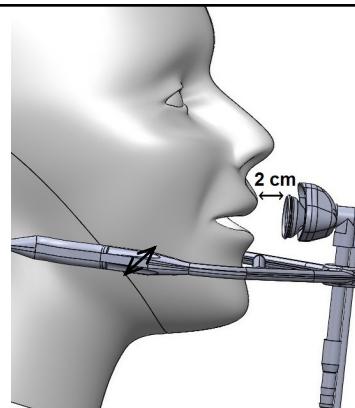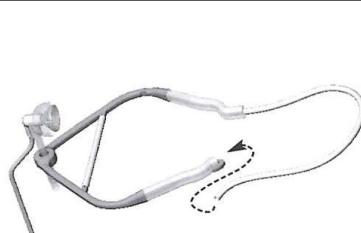

IFU0034O






thebetteroxygenmask.com

Oxygen Flow Settings	Approximate O2 Concentrations
1 LPM	24%-27%
2 LPM	28%-31%
4 LPM	32%-35%
6 LPM	36%-39%
8 LPM	40%-43%
10 LPM	42%-47%
12-15 LPM	48%-50%

Oxygen concentration, FiO2, levels are approximated by the table. End-tidal CO2 sampling waveforms are well defined at gas flows of up to 8 LPM, but waveforms will be damped or diminished at a flow rate greater than 8 LPM.

La concentration d'oxygène et les niveaux FiO2 approximatifs paraissent dans la table. Les formes d'onde d'échantillonnage CO2 en fin d'expiration sont bien définies à des vitesses d'écoulement du gaz de jusqu'à 8 l/mm, mais les formes d'onde seront diminuées à des vitesses de plus de 8 l/mm.

Los niveles de concentración de oxígeno, FiO2, son aproximados en la tabla. Las formas de onda de la muestra de CO2 remanente están bien definidas para flujos de gas de hasta 8 LPM, pero las formas de onda serán apagadas o disminuidas a una tasa de flujo mayor que 8 LPM.

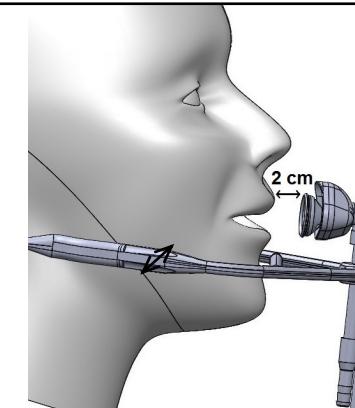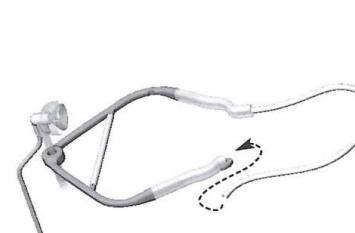

IFU0034O