# Oxy$_2$Pro Le meilleur masque d'intervention



## Pour une meilleure gestion de l'oxygénation et de la ventilation

- ✓ La meilleure livraison FiO2 de sa catégorie
- ✓ Excellent échantillonnage pour la $PCO_2$ de fin d'expiration
- ✓ Meilleur accès des endoscopes grâce à une plus grande fenêtre à membrane
- ✓ Adaptateur pivotant sur 360°
- ✓ Idéal pour les bronchoscopies et les endoscopies, ainsi que les sédations conscientes.
- ✓ Le masque d'intervention Oxy$_2$Pro à usage unique est conçu pour l'administration d'oxygène supplémentaire et la surveillance des gaz expirés par le patient. Il est doté d'une fenêtre permettant au clinicien d'insérer les endoscopes, sondes ou tubes oraux. Il est destiné aux patients non intubés qui respirent spontanément.




# Oxy$_2$Pro Le meilleur masque d'intervention

## Titrage souple d'oxygène, de 5 à plus de 15 l/min


Le masque Oxy$_2$Pro est doté de la nouvelle génération de technologie OxyMask avec un diffuseur triangulaire amélioré à disque champignon qui affine la forme des tourbillons fixes d'oxygène et dirige le flux d'oxygène à une vitesse accélérée vers le nez et la bouche du patient. La grande fenêtre en forme d'étoile facilite l'accès aux voies aériennes du patient tout en maintenant l'oxygénation et la surveillance de la $PCO_2$ de fin d'expiration.

Fournit des flux d'oxygène de 5 à plus de 15 l/min, à une fraction d'oxygène inspiré de 48 à 95 % tout en surveillant le $CO_2$ expiré.

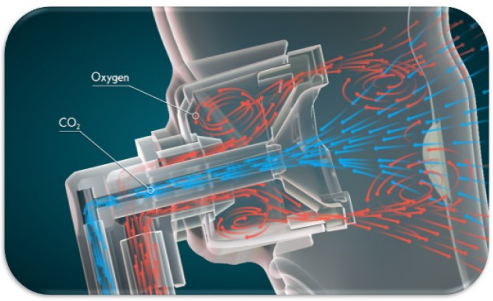


| Débit (l/m) | % d'oxygène inspirer |
|---|---|
| Min. 5 | 48-72 |
| 8 | 67-86 |
| 10 | 73-93 |
| 12 | 79-94 |
| 15 | 85-95 |

**La valeur réelle d'oxygène inspiré peut varier. La fréquence respiratoire, le volume courant et la distance du diffuseur par rapport au visage auront une incidence sur le rendement. Le débit réel requis doit être prescrit en conjonction avec l'oxymétrie pulsée.*

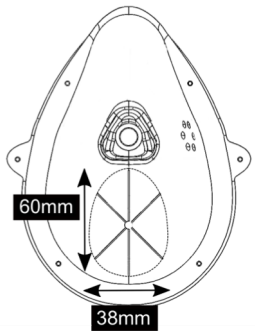



### Excellent échantillonnage pour la PCO2 de fin d'expiration

Pendant l'expiration, on échantillonne du dioxyde de carbone dans notre coupelle de diffusion améliorée. La coupelle est fixée à une conduite d'échantillonnage qui peut être reliée à votre moniteur de capnographie pour obtenir des lectures précises et fiables de $PCO_2$ de fin d'expiration, même à des débits d'oxygène plus élevés.

**$PCO_2$ de fin d'expiration détectée par rapport aux oscillations avec $PCO_2$ de fin d'expiration de 5 %**Tendances de surveillance remarquables de la $PCO_2$ de fin d'expiration à des débits d'oxygène allant jusqu'à 15 litres à la minute.


**Débit d'oxygène de 8 l/min**

$CO_2$ détecté par rapport au temps

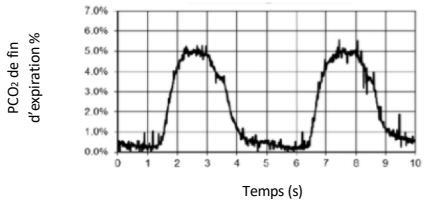



**Débit d'oxygène de 12 l/min**

$CO_2$ détecté par rapport au temps

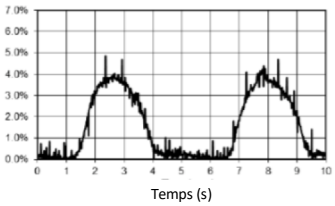


**Débit d'oxygène de 15 l/min**

$CO_2$ détecté par rapport au temps

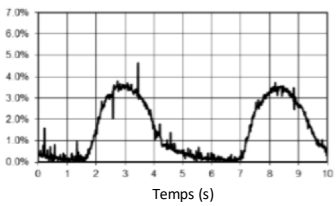


| Code | Description | UDM | Longueur des tubes |
|---|---|---|---|
| PRM-2110-8F | Masque Oxy2Pro-adulte, femelle luer | 10/box | 7' $O_2$ tubing with 10' sampling line |
| PRM-2110-8M | Masque Oxy2Pro-adulte, mâle luer | 10/box | 7' $O_2$ tubing with 10' sampling line |
| PRP-2110-8F | Masque Oxy2Pro-adulte plus, femelle luer | 10/box | 7' $O_2$ tubing with 10' sampling line |
| PRP-2110-8M | Masque Oxy2Pro-adulte plus, mâle luer | 10/box | 7' $O_2$ tubing with 10' sampling line |

Southmedic | Respiratory | Surgical | Blades & Scalpels | Dynamic Tissue Systems

Fabriqué par :
Southmedic Inc. 50,
boul. Alliance Barrie
(Ontario) Canada
L4M 5K3

PO262 Nov 2026

www.thebetteroxygenmask.com
Courriel : custserv@southmedic.com
1 800 463-7146 sans frais en Amérique du Nord 705 726-9383